

SATO

記憶計®

SK-L750シリーズ

取扱説明書

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

ー はじめに ー

このたびは記憶計「SK-L750シリーズ」をお買いあげいただきありがとうございます。

◎この商品は温度または温湿度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保存してください。

（→P.）は関連事項の参照ページを表します。



警 告

本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ気体の測定には絶対に使用しないでください。



爆発注意

爆発する恐れがあり大変危険です

◎ご不明な点がありましたらお買いあげ店または弊社にご相談ください。



注 意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。

- ・分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- ・本器は精密にできていますので落下させたり、振動、衝撃を与えないように注意してください。
- ・直射日光のあたる場所や熱器具の近くでのご使用はやめてください。正しい測定ができないだけでなく、故障の原因となります。
- ・粉塵およびチリやホコリの多い場所、塩分が含まれている気体中でのご使用はしないでください。
- ・温湿度口ガ「SK-L754」は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
- ・結露や雨、水滴、水蒸気がかかる場所でのご使用はしないでください。
- ・温度口ガ「SK-L751」は防水仕様ですが、ACアダプタ使用時は、防水構造ではありません。水がかかる場所でご使用の際は、乾電池を使用してください。
- ・電気的ノイズが発生する環境で使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
- ・機器を設置する際は落下等がないように、十分に注意しておこなってください。
- ・標準空気組成（一般大気）以外でのご使用は絶対にしないでください。
- ・測定範囲外でのご使用は故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- ・オプションのACアダプタ以外をご使用される場合は、定格および仕様が守られているものを選定してください。定格および仕様は「P.20ACアダプタ」をご参照ください。
- ・長時間使用しない場合は電池を取り外してください。電池をいたままにしておきますと電池から液漏れする場合があり、故障の原因となります。

- ・不要になった電池は火中に投入しないでください。
 - ・電池は幼児の手に届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談して下さい。
 - ・環境保全のため使用済み電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理するようお願いします。
 - ・本器をアルコール、シンナー、その他溶剤で洗ったり、拭いたりしないでください。
汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどをよくしぼってから拭いてください。
- ※修理および校正はお買いあげ店または弊社へお申し付けください。

■免責事項

株式会社佐藤計量器製作所は本製品に関して動作確認は行っておりますが、全ての状況下において動作を保証しているわけではありません。

本製品により生じた損害は、直接的および間接的損害を問わず、弊社に一切の賠償責任はないものとします。

※こちらで提供いたします各種ソフトウェアに関しては、日本国内で販売されている各製品と日本語版OSの組み合わせのみ、動作確認を行なっております。

海外機種、海外版OSとの組み合わせにて発生したトラブルに関しましては、一切保証およびサポートいたしかねますのでご了承ください。

■備考

記憶計は株式会社佐藤計量器製作所の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、システム名、製品名等は一般に各社の登録商標または商標です。

概 要

記憶計「SK-L750シリーズ」は温度または温湿度のデータを指示計に記憶ができるデータロガーです。

専用のソフトウェアを使用することで、環境のモニタリングや、収集したデータの解析が可能です。

特 長

●データの保存

本器に、最大で16000データの記憶が可能です。

また、本器に記憶したデータをmicroSDカードにデータのコピーが可能です。

●データの保持

電池が切れても記憶したデータは保持されます。

●防水構造

温度ロガー「SK-L751」はJIS C 0920「IP65」に準拠した防水・防塵構造です。

●4種の記憶方式

使用用途に合わせて記憶方式の選択が可能です。

●センサ互換性

本器と各センサは完全互換性です。

付属品の確認

開封後、梱包内容をご確認ください。

万一不足品がございましたら、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。

記憶計（温度　温湿度）

<input type="checkbox"/> 本体	1台
<input type="checkbox"/> 単3形アルカリ乾電池	2本
<input type="checkbox"/> 解析ソフトウェアCD-ROM	1枚
<input type="checkbox"/> 通信ケーブル	1本
<input type="checkbox"/> 取扱説明書	1冊
<input type="checkbox"/> クイックマニュアル	1部

※microSDカードは付属していません。またセンサは別売りです。


目 次

	ページ
各部の名称	1~5
指示計	1~2
表示部	2~3
キー操作部	4
標準センサ	5
準備	6~8
電池のセット	6~7
センサの接続	7~8
パソコンとの接続	8
機器の設置	8
機能	9~15
動作	9~10
計測モード	9
設定モード	10
記憶モード	14
SDコピー モード	14
予約スタート待機モード	14
記憶データ消去モード	15
リアルタイムモード	15
操作の流れ	16~17
記憶方式	18~19
警報動作	19~20
キーロック機能	20
ACアダプタ	20
エラーメッセージ	21
仕様	22~23
インターネットホームページ	23
保証規定	24
品質保証書	


各部の名称

正面


SK-L751

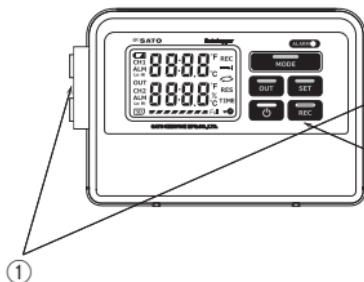

SK-L754



裏面（共通：センサ接続コネクタ数は異なる）

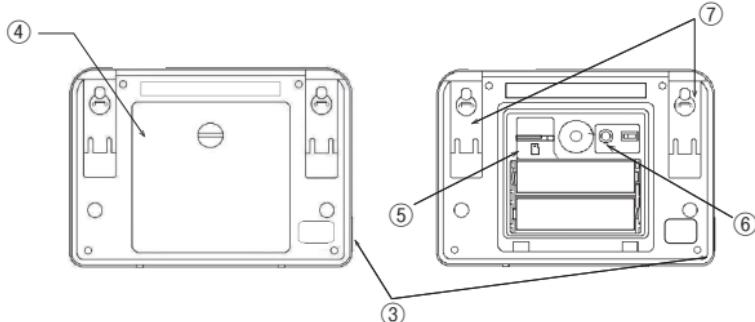


- ①センサ接続コネクタ
- ②操作部
- ③ACアダプタ／通信ケーブル入力部
- ④電池カバー
- ⑤microSDカード挿入口
- ⑥リセットスイッチ

※電源をリセットします。（誤動作した時に使用します。）

- ⑦壁掛けフック

※本器を壁に掛けるときに、引き出して使用します。

表示部

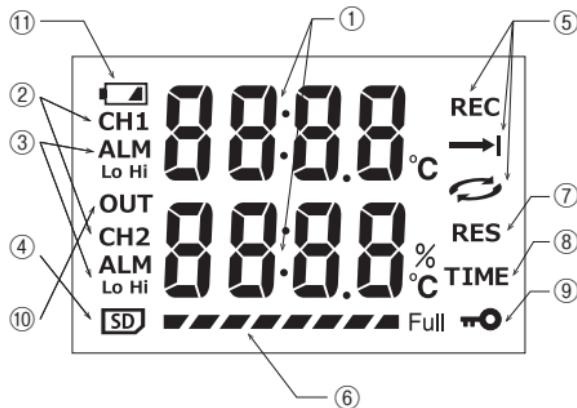

①測定表示部

測定値や、各設定値を表示します。

②CH1 CH2

計測チャンネルを表示します。

③ALM

警報設定時点灯します。警報作動中はALMマークが点滅し、警報設定値を超

えたとき「Hi」、下回ったとき「Lo」が点滅します。



microSDカード挿入時、点灯します。

⑤ REC

記憶中点灯します。

記憶方式としてワンタイムの場合は 、エンドレスの場合は が点灯します。それ以外の場合、計測表示部にデータ数指定時は をページ方式の場合は を表示します。

⑥ データメモリーバーグラフ

本器に記憶したデータ数に応じて1ずつ点灯します。データ数が16000となつたとき、Fullマークが点灯します。

⑦ RES

予約スタート待機中のとき、点滅表示します。

⑧ TIME

日時表示時点灯します。



キーロック機能が作動しているとき点灯します。

⑩ OUT


パソコンと通信しているときに点灯します。



バッテリーが規定値以下となったときに点滅表示します。

注意：バッテリーマークが点滅した直後は記憶を継続しますが、暫くすると記憶は自動で停止します。

キー操作部

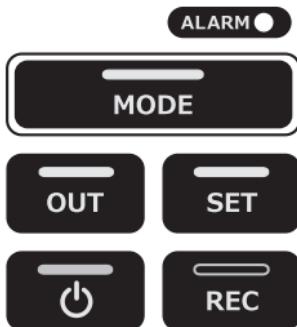

①電源 キー

1秒以上押すと、本器の電源をONまたはOFFします。

電源がONになると、約1秒間LCDが全点灯した後、計測モードに移行します。

②MODEキー

設定モードおよび、設定モード内での次の設定への移行キーです。

③SETキー

計測モードなどでのキーロック設定や、記憶モードでの計測表示をさせるときに使用します。

④RECキー

記憶を開始または終了するときに使用します。

⑤OUTキー


予約スタート待機中に計測値を確認する場合や記憶データをmicroSDカードへコピーするときに使用します。

⑥ALARM


警報設定値を超えたまたは下回ったとき、点灯します。

標準センサ


SK-L751-1 / SK-L754-1



SK-L751-2

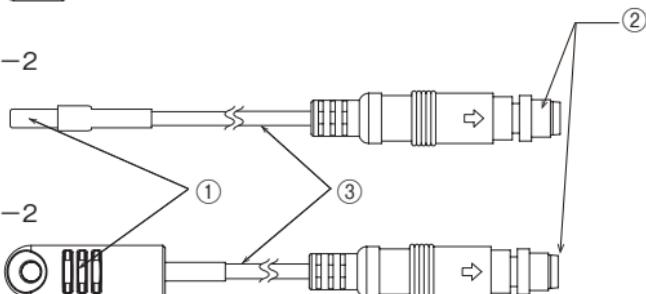

SK-L754-2



①センサ部

②指示計接続コネクタ

③センサコード

準 備

①電池のセット

本器を初めて使用するときやローバッテリーマークが点滅した場合は、以下の手順で電池をセットまたは交換してください。

また、本器はUSBポートへACアダプタの接続も可能です。


電池をセットしている状態でACアダプタを接続すると、優先的にACアダプタからの電源を使用しますので、通常はACアダプタで動作をおこなわせ、停電時などの際に電源のバックアップとして乾電池から電源供給させることも可能です。

・乾電池のセット

本体裏面の電池フタをマイナスドライバーまたはコインなどで反時計方向に回して取り外し、乾電池の極性（+）に注意し、乾電池をセットしてください。


次に、電池フタを外したときと逆の手順で、電池フタを取り付けてください。

※注意：新品の乾電池を使用してください。



・USB（またはACアダプタ）使用の場合

USBキャップを開け、コネクタの向きに注意し、付属のUSBケーブルを接続してください。





注 意

- ・乾電池を交換するときは2本共に同じ種類のもので、すべて新しいものをご使用ください。種類が違ったり、古い電池と混ぜると破裂や液漏れの恐れがあります。
- ・不要になった電池は火中に投入しないでください。電池が破裂してケガや、火傷をする恐れがあります。
- ・乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ・環境保全のため使用済みの電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理するようお願いします。
- ・記憶計温度タイプは防水仕様です。電池蓋を取り付ける際、パッキンがきちんと溝に入った状態を確認し、ネジでしっかりと締め付けてください。締め付けが不十分ですと、水が入り、液漏れや乾電池がショートし、発熱や破裂させる恐れがあり大変危険です。また機器の故障につながります。
- ・記憶計温度タイプをACアダプタで使用する場合、ポートキャップが開いている状態のため、防水性能が保てません。水の掛かる場所でご使用の際は乾電池をご使用ください。


②センサの接続

本器のコネクタと向きを合わせてセンサをまっすぐに挿入し、センサナット部を回し、しっかりと接続してください。締め付けが不十分ですと、防水性能を保持できません。

注意：センサ部をねじったり、曲げたりしないで下さい。機器の故障につながります。

また、温度タイプで一体型センサを使用する場合、CH1にセンサを接続して下さい。CH2にセンサを接続すると、一体型センサの形状制限により、CH1にセンサを接続することができません。

なお、CH2にのみセンサを接続すると、記憶は開始されません。センサは必ずCH1から使用してください。

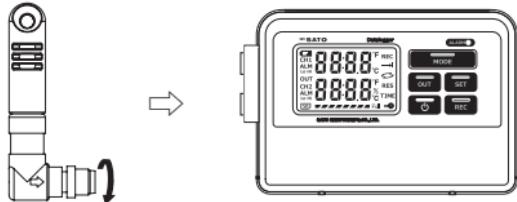

③パソコンとの接続

付属の通信ケーブルでパソコンに接続してください。

基本的に、各設定は専用のソフトウェアでおこないます。

※詳細はソフトウェアの取扱説明書をご確認ください。

④機器の設置

注意：壁に掛けて使用するときは、壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛けフックを引き出して本器を引っ掛けてください。


注意：本器を左右に軽く揺らし、落下しないことを十分確認してください。

壁に掛けた状態で本器をむやみに引っ張ると、壁掛けフックが外れる恐れがあります。

取り付け寸法

壁面への取り付けの際、下図を参照し、M3ネジなどをご使用ください。


※注意：落下等なきよう取り付けには十分ご注意願います。



機能

動作


各設定は専用ソフトウェアでおこないますが、各キーにより以下の動作をおこないます。

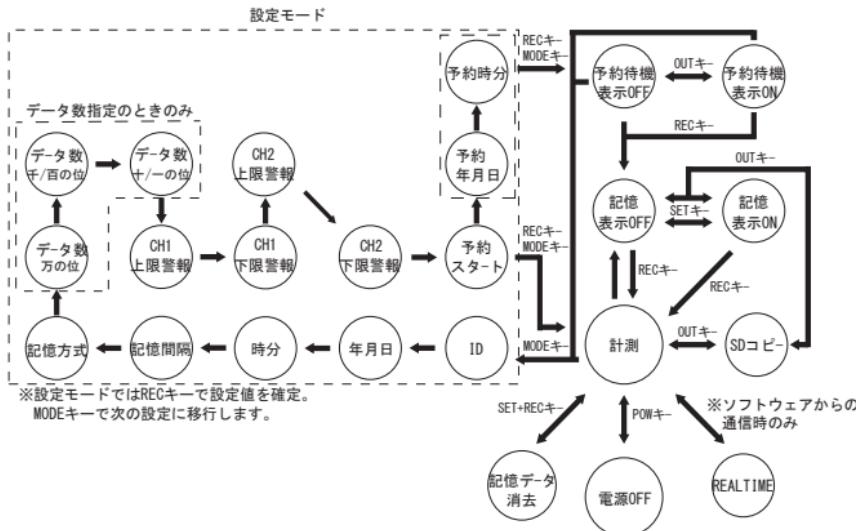

①計測モード

環境を計測し、測定した結果をLCDに表示するモードです。

センサを接続し、電源キーを1秒以上押下すると、全点灯表示後、測定値表示をおこないます。

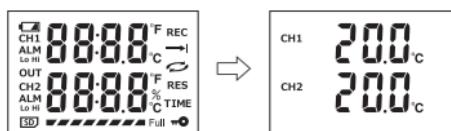

②設定モード

各設定をおこなうモードです。

計測モードや、予約待機モードにてMODEキーを押すと、設定モードに移行します。

※キー操作では、警報ON/OFF、記憶間隔、記憶方式、予約スタートON/OFFのみ設定が可能です。詳細設定は専用ソフトウェアでのみ可能です。

※設定モードにて1分間操作をおこなわないと、それまでにRECキーで確定した設定値を反映した上で、自動で計測モードに戻ります。

注意：設定の変更はRECキー押下で、設定値が確定します。設定値を変更しても、RECキーを押下しないで、MODEキーで移行した場合、変更した設定値は変更されません。

●工場出荷時の設定

工場出荷時の設定は以下の通りです。

ご使用方法にあわせて専用のソフトウェアにて各設定を行ってください。

項目	設定
ID	000000
年月日	2018.1.1
時間	0:00
記憶間隔	1分
記憶方式	ワンタイム
CH1 上限警報	OFF
CH1 下限警報	OFF
CH2 上限警報	OFF
CH2 下限警報	OFF
予約スタート	OFF
キーロック	OFF

●ID表示



機器に設定されているIDを表示します。工場出荷時はid000000です。

IDは専用ソフトウェアでのみ設定が可能です。

※IDはid以降の6桁が設定可能となります。設定できる文字には制限があります。詳細はソフトウェアにて確認ください。

●年月日、時分表示



機器に設定されている年月、時分を表示します。

機器の使用を開始するに当たり、まず最初に専用ソフトウェアで現在日時の設定をおこなってください。

●記憶間隔表示



機器に設定されている記憶間隔を表示します。


選択可能な記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分から選択可能です。

記憶間隔は本体のキー操作からも設定可能です。

設定はSETキーを押下するたびに、設定値が順に更新されます。

RECキーを押下すると設定した記憶間隔が確定されます。

●記憶方式表示

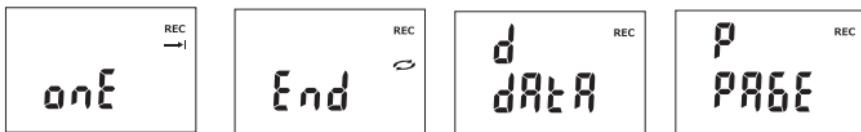

機器に設定されている記憶方式を表示します。

各記憶方式については、「P.18記憶方式」を参照ください。

※記憶方式は本体のキー操作からも設定可能です。

設定はSETキーを押下するたびに、記憶方式が変更されます。

RECキーを押下すると設定した記憶方式が確定されます。

データ数指定を設定した場合、記憶するデータ数の設定が必要となります。



上段セグメントが10000の、下段が1000以下の桁設定になります。

SETキーにて設定値を変更し、RECキーで確定の上、次の桁の設定に移行させます。

※SETキーを2秒以上押下すると設定値が早く更新されます。

●警報設定表示



機器に設定されている警報設定（ON/OFF）を表示します。

警報がONに設定されている場合、計測モード時、LCDに「ALM」マークが点灯します。


※警報値は表示されません。ON/OFFのみの表示となります。

警報値は専用ソフトウェアから設定が可能です。

機器ではSETキーでON/OFFのみ設定が可能です。

※図はチャンネル1のアラーム設定表示になります。

●予約スタート設定表示

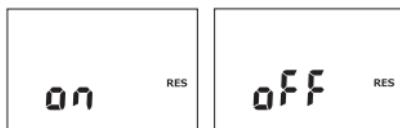

機器にて予約スタートON/OFF設定が可能です。

※現在日時より予約日時が前の場合、設定はできません。


予約日時は専用のソフトウェアからのみ、設定が可能です。

SETキーでONに設定し、RECキーで設定を確定すると、機器に設定されている予約日時を表示します。



③記憶モード

本モードでは設定された記憶方式に基づき、本体に測定値の記憶をおこないます。

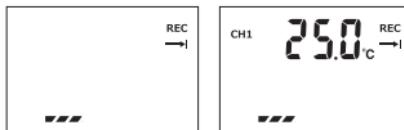

記憶中にSETキーを押すと、記憶をおこないながら現在の計測値を表示します。

注意：計測値表示をおこないますと、計測値表示を行わないときより電池寿命は短くなります。

④SDコピー モード

機器に記憶している記憶データをmicroSDカードにコピーします。

OUTキーを2秒以上押下するとコピーを開始します。

コピーが終了すると自動でもとの状態に戻ります。

※記憶中にコピーをおこなうと、コピーを押下された時点までのデータをコピーします。



⑤予約スタート待機モード

予約スタートを設定後、記憶を開始するまでの間、本状態となります。

予約スタート待機中にOUTキーを押すと、現在の計測値を表示します。

再度OUTキーを押すと、もとのモードに戻ります。


※予約スタート待機中に、MODEキーを押下すると、設定モードに移行します。設定モードに移行すると、予約スタートは自動的にOFFになります。

再度ONにしたい場合、設定モードにてONにする。または専用ソフトウェ

アで予約スタート設定をONにしてください。


注意：予約スタートをおこなうと、自動で機器に記憶している記憶データを消去します。必要なデータは予約スタートをおこなう前に、データの回収をおこなってください。

また、予約スタート待機中にローバッテリーや、センサを外したり、異常が発生すると、予約時刻に記憶を1回のみ行い、自動で記憶を終了します。予約開始を行う時は、センサ状態や、電池等の状況を確認ください。

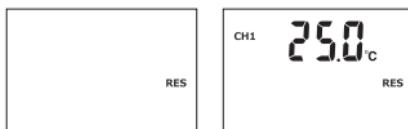

⑥記憶データ消去モード

SETキーを押しながらRECキーを2秒以上押下すると記憶データを消去します。消去後は自動でもとのモードに戻ります。



⑦リアルタイムモード

本モードはパソコンと接続している時に計測値をリアルタイムでソフトウェアに送信するモードです。

操作は専用ソフトウェアでのみ可能です。




操作の流れ

指示計の操作の流れは以下の通りです。

専用ソフトウェアにて各設定／操作をおこなってください

図 フロー図

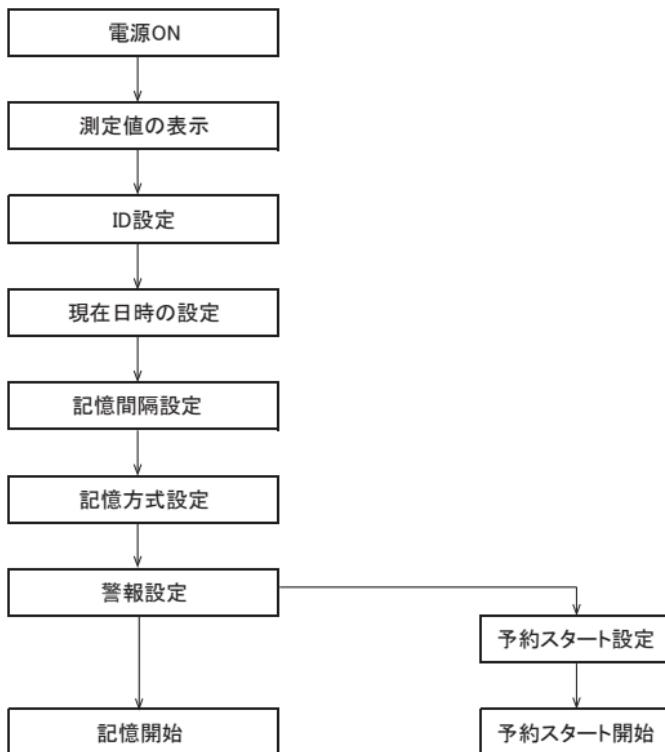

指示計と専用ソフトウェアで可能な操作の関係は次項を参照ください。

指示計とソフトウェアでの操作の関係

項目	指示計	ソフトウェア
指示計の電源 ON/OFF	○	×
ID 設定	×	○
年月日	×	○
時間	×	○
記憶間隔	○	○
記憶方式	○	○
警報 ON/OFF	○	○
警報値	×	○
予約スタート ON/OFF	○	○
予約日時	×	○
リアルタイム	×	○
キーロック	○	○
記憶データ消去	○	○
SD コピー	○	○

記憶方式

記憶計は4つの記憶方式の設定が可能です。

ご使用用途に合わせて記憶方式を選択してください。

●ワンタイム方式

メモリが一杯になるまでデータを記憶を続ける方式です。

記憶データ数が16000になると記憶を終了します。



●エンドレス方式


メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこない記憶を続ける方式です。



●データ数指定方式

あらかじめ記憶するデータの数を指定する方式です。

記憶させるデータ数は1～16000の間で指定が可能です。



●ページ方式

本体のメモリを4分割（4ページ）する方式です。1台で異なる場所等を順次記憶していくことができます。


1つのページは4000データ記憶することが可能です。



1ページ 2ページ 3ページ 4ページ

各ページ最大4000データ

●バー点灯数と記憶データ数

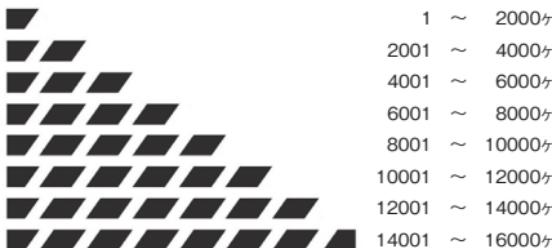

バー点灯数と記憶データ数

16000データを記憶すると、メモリーバーの右側にFullが点灯します。

注意：本器に記憶データが残っている状態で、RECキーを2秒以上押し続けると、記憶データを消去し、再度記憶を開始します。

必要なデータは必ず、ダウンロードまたはmicroSDカードへの保存を行ってください。

記憶を停止させる場合も、RECキーを2秒以上押し続けます。RECマークが消灯し、記憶を停止します。

警報動作

測定値が警報設定値を超える（Hi）または下回った（Lo）とき、「ALM」および、設定を超えた条件に対して「Hi/Lo」のマークが点滅表示し、ALARMランプが点灯します。

計測値が設定値内に戻ると、「Hi/Lo」のマークおよび、ALARMランプは消灯します。

※警報作動中にSETキーを押しながら、MODEキーを押すと、警報動作を解除（OFF）します。

※注意：計測値を表示しない予約待機中や、各機能設定中の時は、計測動作を行っていないため、警報は作動しません。

※注意：接続しているセンサが外れると、警報設定はOFFとなり、設定値は初

期値に戻ります。



キーロック機能

記憶中や予約スタート待機モードなどでの誤操作防止として、キーロック機能を有しています。

計測モード、予約スタート待機モード時に、SETキーを2秒以上押下すると、キーロック機能が有効となります。キーロック機能有効時は、表示部にキーロックマークが点灯し、SETキー以外はキー操作が無効となります。

キーロックの解除は設定時と同様にSETキーを2秒以上押下することで、解除となります。

ACアダプタ

オプションのACアダプタ以外をご使用される場合は、次の仕様のものを選んでください。

<2次側出力> 電圧 : DC5V
電流 : 1A
プラグ形状 : USB Mini-B

エラーメッセージ

表示	エラー内容	対処方法
H _i	測定値が表示範囲の上限を超えていている。	測定範囲内でご使用ください。
L _o	測定値が表示範囲の下限を超えていている。	
E _r	測定値が表示範囲の上限や下限を超えてさらにH _i /L _o を超えている。またはセンサ故障	センサを測定範囲に戻してください。 症状が改善されない場合、センサの故障が考えられます。 販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
E _r 0	電源投入時に異常な信号が入力された。	電源投入時に異常な信号（ノイズ）等が入力した場合に発生します。 一度、本器の電池BOXにあるRESETスイッチを押して、再起動させてください。 症状が改善されない場合、センサの故障が考えられます。 販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
E _r 1	センサ接続時、センサ情報を読み込めなかつた。	電源を一度OFFにし、再度電源をONにしてください。 症状が改善されない場合、センサの故障が考えられます。 販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
E _r 2	センサが接続されていない。またはセンサ故障	指示計にセンサが接続されていない状態で電源をONにすると表示されます。センサを接続してください電源をONにしてください。 センサを接続している状態でE _r 2が表示される場合、センサの故障が考えられます。 販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
E _r 3	記憶データが無い状態でmicroSDカードヘデータのコピーをおこなつた。またはカードが挿入されていない。	指示計のデータメモリーバーグラフで、記憶データがあるか確認ください。またmicroSDカードが挿入されていることを確認してください。
E _r 4	異なる機種のセンサが接続されている。	温度タイプには温度センサ、温湿度タイプには温湿度センサを接続してください。
E _r 5	現在日時より過去の予約日時で予約をONにした。	専用ソフトウェアで予約日時の変更をおこなってください。
E _r 6	指示計に記憶データが残っているときに、記憶方式を変更しようとした。	記憶方式を変更する場合、記憶データを消去してから設定をおこなってください。

エラーメッセージは表示部に表示されます。

※各異常表示発生時、記憶は開始されません。

仕 様

製品名	2ch 温度口ガー	温湿度口ガー
型 式	SK - L751	SK - L754
製品番号	8800-00	8870-00
測定範囲	※接続するセンサにより測定範囲は異なります。 使用されるセンサの取扱説明書を参照ください。	
分解能	0.1°C	0.1°C / 0.1%rh
表示精度	± 0.2°C at 0 ~ 40°Cにおいて 以外は ± 0.3°C	温度: ± 0.2°C at 0 ~ 40°C において 以外は ± 0.3°C 湿度: ± 0.2%rh at 0 ~ 40°C 以外は ± 0.3%rh
表示サンプリング	約 1 秒	
表示機能	温度／湿度警報 (ALM)、記憶方式、状態表示 (REC / RES)、記憶量 (バー) SD メモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示	
計測チャンネル数	温度 2 チャンネル	温度、湿度各 1 チャンネル
記憶容量	各チャンネル 16000 データ	
記憶間隔	1 秒・2 秒・5 秒・10 秒・15 秒・30 秒・1 分・2 分・5 分・10 分・ 15 分・30 分・60 分・90 分の 14 通り	
外部メモリ	microSD / SDHC 32GB まで (※)	
使用環境条件	-10 ~ 60°C 85%rh 以下 (結露無きこと)	
保管環境条件	-10 ~ 60°C 85%rh 以下 (結露無きこと)	
電 源	単 3 形アルカリ乾電池 2 本 または AC アダプタ	
電池寿命 (at23°C)	計測モード時 約 500 時間 記憶モード時 各記憶間隔にて 16000 データ記憶が可能 (LCD 消灯時)	
寸 法	約 (W) 114 × (H) 80 × (D) 35mm ※突起部含まず	
質 量	約 232g (電池含む)	約 227g (電池含む)
保護等級	IP65 (※分離型センサ接続時)	
付属品	取扱説明書 (本書)	1 冊
	単 3 形アルカリ乾電池	2 本
	解析ソフトウェア CD-ROM	1 枚
	通信ケーブル	1 本
	クイックマニュアル	1 部

※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。

本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。

弊社では下記のSDカードで動作を確認しています。

BUFFALO社製 16GB／32GB RMSD-Y016U1A／RMSD-Y032U1A

ELECOM社製 16GB／32GB MF-RUMSD16GL／MF-RUMSD32GL

SanDisk社製 16GB／32GB SDSDQUL-016G-J35A／

SDSDQUL-032G-J35A

※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※センサの仕様に関しては、ご使用されるセンサに付属されている取扱説明書を参照ください。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

オプションの詳細情報も、こちらからご覧いただけます。

ホームページアドレス <http://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
 - ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ日、販売店名等)の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。
お手数でも※印箇所にご記入の上本器の最終ご使用
者のお手許に保存してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商
品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用
したり、第三者に提供する事は一切ございません。

品名 記憶計 SK-L750シリーズ

※お客様名

※ご住所

※TEL ()

●以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただきください。

お買いあげ店名

印

ご住所

TEL ()

お買いあげ年月日

年 月 日

SK 榎社 佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

SK 榎社 佐藤計量器製作所